



EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type-examination certificate

Ausgestellt für:
Issued to:

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Im Tiefen See 45
64293 Darmstadt

Rechtsbezug:
In accordance with:

Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über Messgeräte (ABl. L 135 S. 1), umgesetzt durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Eichordnung vom 8. Februar 2007 (BGBl. I S. 70).
Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments (OJ L 135 p. 1), implemented by the Fourth Ordinance for amending the Verification Ordinance dated 8 February 2007 (Federal Law Gazette I, p. 70).

Geräteart:
Type of instrument:

Selbsttätige Waage zum Abwägen *Automatic gravimetric filling instrument*

Typbezeichnung:
Type designation:

DWS2103 SWA

Nr. der Bescheinigung:
Certificate number:

DE-11-MI006-PTB003

Gültig bis:
Valid until:

18.05.2021

Anzahl der Seiten:
Number of pages:

16

Geschäftszeichen:
Reference No.:

PTB-1.12-4045636

Benannte Stelle:
Notified Body:

0102

Ort, Ausstellungsdatum:
Date of issue:

Braunschweig, 19.05.2011

Zertifizierer:
Certifier:

Im Auftrag
By order

Dr. Oliver Mack

Siegel
Seal



Bewerter:
Evaluator:

Im Auftrag
By order

Dipl.-Ing. K. Schulz

Hinweise

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gültigkeit. Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Note

EC type-examination certificates without signature and seal are not valid. This EC type-examination certificate may not be reproduced other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003
dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Seite 2 von 16 Seiten
Page 2 of 16 pages

Zertifikatsgeschichte / History of certificate

Zertifikatsausgabe <i>Issue of certificate</i>	Datum <i>Date</i>	Änderungen <i>Modifications</i>
DE-11-MI006-PTB003	19.05.2011	Erstbescheinigung / first issue

Allgemeines

General

Diese Anlage ist zweisprachig; der Originaltext ist deutsch.
This annex is written in two languages; original wording in German.

Der Hersteller ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung der einheitlichen Fertigung des Gesamtgerätes sowie von Modulen, die als Bestandteil des Gerätes verwendet werden (Richtlinie 2004/22/EG, Anhang B, Nr. 4.6).

The manufacturer is responsible for ensuring a consistent production of the complete instrument as well as of modules which are used as part of the instrument (Directive 2004/22/EC, Annex B, No. 4.6).

Rechtsvorschriften:

Legal basis

Für die in dieser Bescheinigung genannten Geräte gilt die Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über Messgeräte (ABl. L 135 S. 1), umgesetzt durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Eichordnung vom 8. Februar 2007 (BGBl. I S. 70).
For the instruments listed in this certificate the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council on measuring instruments of 31 March 2004, implemented by the Fourth Ordinance for amending the Verification Ordinance dated 8 February 2007 (Federal Law Gazette I, p. 70), applies.

einschließlich / including

Anhang I, Grundlegende Anforderungen / *Annex I, Essential Requirements*

Anhang MI-006 / *Annex MI-006*

Angewendete harmonisierte Normen bzw. normative Dokumente:

Harmonised standards and normative documents applied

OIML R61/2004 und / and OIML R51/2006 (letztere in Bezug auf die Elektromagnetische Verträglichkeit – EMV / *(the latter with regard to electromagnetic compatibility - EMC)*

Weitere angewendete Regeln / further regulations applied:

WELMEC-Leitfaden / *WELMEC Guide 7.2 (Ausgabe 2009 / issue 2009)*

WELMEC-Leitfaden / *WELMEC-Guide 2.4 (Ausgabe August 2001 / issue August 2001)*

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003
dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Seite 3 von 16 Seiten
Page 3 of 16 pages

1 Beschreibung *Description of the type*

1.1 Aufbau *Structure*

Die selbsttätige Waage zum Abwägen (SWA) besteht grundsätzlich aus:

- der in ein separates Gehäuse eingebauten Anzeige- und Bedieneinrichtung DWS2103 (mit Anzeigeeinrichtung und Bedientastatur, auch zum Einbau in eine Schalttafel vorgesehen),
- der Auswerteeinheit AED9xxx mit A/D-Wandler AD103C
- dem an diese Auswerteeinheit AED9xxx über Kabel angeschlossenen Lastaufnehmer.
- einer Zuführungseinrichtung für das Wägegut, wo erforderlich mit geeignetem Feinstrom zum reproduzierbaren Abschluss des Füllvorgangs; bei Entnahmewägung aus dem Lastbehälter übernimmt die Entleerungseinrichtung diese Funktion;

Die Waage kann fest eingebaut oder mit einem nicht fest eingebauten Lastaufnehmer ausgerüstet sein. Der Lastaufnehmer kann mit einer oder mehreren Dehnungsmessstreifenwägezellen (DMS-WZen) mit analogem Ausgangssignal ausgestattet sein.

The automatic gravimetric filling instrument (AGFI) is generally composed of:

- *the indicating and operating device DWS2103 in a separate housing (having a display unit and an operating keyboard, designed for control panel mounting)*
- *the analogue data processing unit AED9xxx equipped with A-to-D converter AD103C*
- *the load receptor connected via cable.*
- *a feeding device for the material to be weighed, in case of need including a suitable fine feeding device for reproducibly finishing the filling process. When performing discharge weighing the discharge device carries out that task;*

The instrument may be stationarily mounted or be equipped with a non-stationarily mounted load receptor. The load receptor may be equipped with one or several strain gauge load cells (SG-LCs) providing an analogue output signal.

1.1.1 Wägeablauf *Weighing principle*

Die Abwägungen bleiben in Gebinden getrennt. Eine Big-Bag-Funktion ist möglich. Bei automatischer Nachstromkorrektur und automatischen Kontrollwägungen ist die Stillstandskontrolle wirksam.

The fills remain in separate batches. A Big-Bag function is possible. With automatic final feed correction and automatic check weighing the stability of equilibrium device is operating

Die Wägung erfolgt statisch.
The instrument weighs statically.

1.2 Messwertaufnehmer *Measuring transducers*

Es dürfen beliebige Dehnungsmessstreifenwägezellen (DMS-WZ) eingesetzt werden, wenn die Bedingungen in Nr. 4.1.2 erfüllt werden.
Any kind of strain gauge load cells (SG-LC) may be used provided the conditions of No. 4.1.2 are met.

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003
dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Seite 4 von 16 Seiten
Page 4 of 16 pages

1.3 Messwertverarbeitung *Processing measuring values*

- Hardware *Hardware*

Die Auswerteeinheit AED9xxx (mit A/D-Wandler AD 103C) stellt die Speisespannung für die DMS-WZ zur Verfügung, verstärkt die Ausgangsspannung der DMS-WZ und führt die A/D-Wandlung durch. Die weitere Verarbeitung des Messsignals erfolgt im Mikroprozessorsystem des AD103C. Der Gewichtswert wird dann verschlüsselt über die Schnittstelle (Bus-System nach RS485 oder CAN) an das DWS2103 übertragen und dort angezeigt. Er kann über verschiedene Schnittstellen ausgegeben werden.

The analogue data processing unit AED9xxx (with A-to-D converter AD103C) supplies the excitation voltage for the SG-LCs, amplifies the output signal of the SG-LCs, and performs the A/D conversion. The further processing of the measuring signal is done by the microprocessor system within the AD103C. The encrypted weighing result is then sent via the interface (bus system as per RS485 or CAN) to the DWS2103 where it is displayed. It can be sent out via several interfaces.

- Software *Software*

Die Software ist fest im DWS2103 und im AED9xxx verankert. Ein Laden der Software ist nicht vorgesehen.

The software is inextricably linked to the DWS2103 and the AED9xxx. Loading of software is not intended.

1.4 Messwertanzeige *Measurement indicator*

Der Wägeergebnis wird in einer 240 x 64 Punkte LC-Anzeige dargestellt (DWS 2103). Am unteren Rand des Bildschirms werden die Symbole für die Belegung der vier Funktions-tasten ausgegeben. Zur Bedienung und Eingabe dient darüber hinaus eine weitere Folien-tastatur mit 15 Tasten.

The weighing result is shown on 240 x 64 dot matrix LC display (DWS 2103). At the lower edge of the screen there are symbols showing the meaning of the function keys. A further foil keyboard of 15 keys serves to operate the weighing instrument and to type in data.

1.5 Optionale Einrichtungen und Funktionen, die der Messgeräte-richtlinie unterliegen (Bezug auf DIN EN 45501 in Klammern) *Permitted functions and devices in conformity with the Directive (reference items of DIN EN 45501 in brackets)*

Folgende Einrichtungen sind im AED9xxx mit AD103C realisiert:

- Einschaltnullstelleinrichtung (max. 20 % von Max) (T.2.7.2.4)
- halbautomatische Nullstelleinrichtung (T.2.7.2.2)
- Nullnachführeinrichtung (T.2.7.3)
- Selbsttätige Nullstelleinrichtung, (OIML R61, T.2.4.3)
- halbautomatische, subtraktive Tarausgleichseinrichtung (T.2.7.4.1)
- Umschaltung zwischen Brutto- und Nettoanzeige nach Tarierung

Folgende Einrichtungen sind im DWS2103 realisiert:

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003
dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Seite 5 von 16 Seiten
Page 5 of 16 pages

- Anzeigeeinrichtung mit erhöhbarer Auflösung (T.2.6)
Nach Tastendruck für maximal fünf Sekunden, signalisiert durch „x10“
in der Status-Zeile
- Mehrbereichswaage, Anzeige des eingeschalteten Wägebereiches (T.3.2.7)
durch Symbole in der Status-Zeile
- Eingabe von Soll-, Grenz-, Toleranzwerten usw.
Die Werte werden in der Hauptanzeigeeinrichtung angezeigt, sie sind besonders gekennzeichnet, z.B. blinkend
- Prüfeinrichtungen zur Erkennung bedeutender Störungen: (5.1)
Die Fehleranzeige erfolgt in der Form „CODE xxxx“ (xxxx = Fehlercode)
mit Erklärung
- Einheitenauswahl bei der Inbetriebnahme (Kontrolle der Konformität (2.1)
nach 2004/22/EG, Anhang D oder F) und Übertragung der Gewichtswerte
gemäß den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die Einheiten im
Messwesen.
- Eichfähiger Datenspeicher für Gewichtswerte:
Nach einem Abdruckbefehl werden die Daten in den Speicher geschrieben. Die Daten
können wie folgt gesucht und ausgelesen werden:
 - a) Parametermenü „Information – Wäageergebnis“ aufrufen.
 - b) Tasten F2 „↓“ und F3 „↑“ betätigen, um zum Datensatz zu scrollen oder
Drucknummer eingeben.

The following devices are realised within the AED9xxx with AD103C:

- Initial zero setting device (max. 20 % of Max) (T.2.7.2.4)
- Semi-automatic zero setting device (T.2.7.2.2)
- Zero tracking device (T.2.7.3)
- Automatic zero setting device (OIML R61, T.2.4.3)
- Semi-automatic subtractive tare balancing device (T.2.7.4.1)
- Toggling between gross and net weight after tare operation

The following devices are realised within the DWS2103:

- Extended indicating device (max. 5 s) (T.2.6)
by simultaneously pressing keys „+“ and „-“ for 5 seconds the resolution is multiplied by 10
additionally notified by LED „1/10 e“
- Multi range instrument with indication of selected weighing range (T.3.2.7)
by symbols within the status row
- Input of preset values, limits and tolerances etc.
The figures are displayed within the main indicating device and are specially designated,
e.g. by flashing
- Device for detecting significant faults: (5.1)
The errors are shown in the format „CODE xxxx“ (xxxx is an error code)
accompanied by an explanation
- Selecting units at verification state; displaying, printing and transmission of weights in (2.1)
accordance with the provisions of Community legislation on units of measurement.
- Data storage device for weights:
After a print command the data are being stored within the memory. The data can be retrieved
and shown as follows:
 - a) Call parameter menu „information – weighing result“.
 - b) Operate keys F2 „↓“ and F3 „↑“ in order to scroll to the data set or to enter the print number.

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003

dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Seite 6 von 16 Seiten

Page 6 of 16 pages

1.6 Technische Unterlagen

Technical documents

- „Bedienungsanleitung DWS2103 Digitale Waagenanzeige“ Nr. / No. I2927-1.0 de
- „Bedienungsanleitung DWS2103 Kommunikationsbefehle“ Nr. / No. I3015-1.0 de
- „Eickonzept DWS2103“, Stand vom / issue dated 11.02.2010
- Zeichnung Nr. L877.PCB, Blatt 1 bis 6 vom 08.04.2008 / drawing No. L877.PCB, sheet 1 to 6, dated 08.04.2008
- Zeichnung Nr. S877.SCH, Blatt 1 bis 10 vom 08.04.2008 / drawing No. S877.SCH, sheet 1 to 10, dated 08.04.2008
- Zeichnung Nr. / drawing No. 565.42-2122.3, Stand / issue dated 22.08.2005 (AD103C)
- Zeichnung Nr. / drawing No. 565.42-6003.2, Stand / issue dated 17.05.2006 (AD103C)
- Zeichnung Nr. / drawing No. 565.14-2122.3, Stand / issue dated 02.03.2009 (AED9101C)
- Zeichnung Nr. / drawing No. 565.14-6004.3, Stand / issue dated 23.09.2010 (AED9101C)
- Zeichnung Nr. / drawing No. 565.41-2123.3, Stand / issue dated 09.11.2009 (AED9201B)
- Zeichnung Nr. / drawing No. 565.41-6021.2, Stand / issue dated 07.11.2008 (AED9201B)
- Zeichnung Nr. / drawing No. 565.39-2122.3, Stand / issue dated 12.05.2009 (AED9301B)
- Zeichnung Nr. / drawing No. 565.39-6022.2, Stand / issue dated 12.05.2009 (AED9301B)
- Zeichnung Nr. / drawing No. 565.57-2120.3, Stand / issue dated 30.03.2005 (AED9401A)
- Zeichnung Nr. / drawing No. 565.57-6001.2, Stand / issue dated 11.03.2005 (AED9401A)
- Zeichnung Nr. / drawing No. 565.59-2120.3, Stand / issue dated 26.07.2007 (AED9501A)
- Zeichnung Nr. / drawing No. 565.59-6001.3, Stand / issue dated 08.02.2007 (AED9501A)

Dokumente nach Anhang B, Nr. 4.6 der MID / Documents according to Annex B, paragraph 4.6 of MID:

Schreiben der Firma / letter from HBM vom / dated 06.12.2010

2 Technische Daten

Technical specifications

2.1 Waagen

Weighing instruments

Messgröße / measuring quantity

Masse / mass

Der richtlinienkonforme Messwert ist das eingestellte Sollgewicht für die Abwägung.

The measuring value in conformity with the Directive is the preset weight value of the fill.

Ein weiterer richtlinienkonform ermittelter Gewichtswert ist das Istgewicht der Füllung bei der Kontrollfunktion.

A further measuring value in conformity with the Directive is the actual value of the filling when performing the weighing for correcting the fine feed.

Genauigkeitsklasse / accuracy class

Referenzgenauigkeitsklasse X(0.2), X(0.5), X(1) oder X(2)

Reference accuracy class X(0.2), X(0.5), X(1), or X(2)

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003
dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Seite 7 von 16 Seiten
Page 7 of 16 pages

Messbereich / measuring range

Max $\geq 0,1$ kg
Max ≥ 0.1 kg

Die Wägebereiche mit Höchstlast, Mindestlast, Teilungswert und Anzahl der Teilungswerte können unter Beachtung der für die verwendeten Wägezellen und für das Auswertegerät gültigen Grenzwerte (siehe Nr. 3.2) gemäß Nr. 2 und 3 des Anhangs I zur Richtlinie 2009/23/EG gewählt werden.

Weighing ranges including minimum load, scale interval and number of scale intervals may be chosen in accordance with Nos. 2 and 3 of Appendix I to Directive 2009/23/EC, considering the limits of the indicator and the load cells used (see Nos. 3.2).

Minfüll (Mindestfüllmenge):
Minfill (minimum fill):

In Abhängigkeit vom Teilungswert (d) beträgt Minfüll der Waage:
Depending on scale interval (d) of the AGFI Minfill is:

d (g)	Mindestfüllmenge Minfüll / Minfill (in g)			
	X(0.2)	X(0.5)	X(1)	X(2)
1	4533	1813	453	151
2	9066	3626	1814	454
5	33995	9065	4535	2265
10	67990	27200	9070	4530
20	135980	54400	27200	9060
50	339950	136000	68000	34000
100	679900	272000	136000	68000
200	1359800	544000	272000	136000
≥ 500	$\geq 6799 d$	$\geq 2720 d$	$\geq 1360 d$	$\geq 680 d$

Max. Anzahl Teilungswerte	:	$n \leq 6000$ (im statischen Betrieb)
Max. number of scale intervals:	:	$n \leq 6000$ (static operation mode)
Taraausgleichsbereich	:	≤ 100 % von Max
Range of tare balancing	:	≤ 100 % of Max
Tarawägebereich	:	≤ 100 % von Max
Range of tare weighing	:	≤ 100 % of Max
Taraeingabebereich	:	≤ 100 % von Max, respektive Max ₁ bei
Preset tare range	:	Mehrteilungswaagen / ≤ 100 % of Max, or Max ₁ with multi interval instruments respectively

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003
dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Seite 8 von 16 Seiten
Page 8 of 16 pages

- Umgebungsbedingungen / Einflussgrößen

- Klimatisch: Temperaturbereich: -10 °C bis 40 °C
Feuchtigkeit: bis 85 % bei 40 °C, nicht betauend
- Mechanisch: nicht anwendbar (siehe MI-006)
- Elektromagnetisch: E2 (OIML D11)

- Environment / influence quantities

- Climatic: Temperature range: -10 °C to 40 °C
Humidity: up to 85 % at 40 °C, not condensing
- Mechanical: not applicable (see MI-006)
- Electromagnetic: E2 (OIML D11)

2.2 Technische Daten der Auswerteeinheit AED 9xxx

Technical data of the analogue data processing unit AED 9xxx

Anzahl der Teilungswerte n	≤ 6000
Genauigkeitsklasse nach OIML R76	III
Versorgungsspannung:	6 V bis 30 V DC
Wägezellen-Speisespannung:	5 V DC
Eingangssignalbereich (Messspannung):	0... 15 mV
Fehleranteil p _i	0,5
Kleinstes zulässiges Eingangssignal:	0,5 µV/Teilungswert
Wägezellenimpedanzbereich:	42 Ω bis 1150 Ω (Resultierender Widerstand aller angeschlossenen Wägezellen)
Wägezellenanschluss:	in 4 oder 6-Leiter-Technik
Maximaler Widerstand des Verbindungskabels (Einzelader) zum Klemmenkasten der Wägezellen entsprechend einer spezifischen Kabellänge von	714 m/mm ² (Werte gültig für Kupfer/ ρ = 0,0175 Ω mm ² / m). Die Kabellänge darf unabhängig vom Querschnitt jedoch in keinen Fall 100 m überschreiten. Bei Anschluss der Wägezelle in 4-Leiter-Technik an die Auswerteeinheit darf das Wägezellenkabel weder verlängert noch gekürzt werden.

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003
dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Seite 9 von 16 Seiten
Page 9 of 16 pages

Number of scale intervals n	≤ 6000
Accuracy class as per OIML R76	III
Supply voltage:	6 V to 30 V DC
Load cell excitation voltage:	5 V DC
Input signal range:	0 ... 15 mV
Smallest permissible input signal:	0.5 μ V / scale interval
Error portion p_i	0.5
Load cell impedance range:	42 Ω to 1150 Ω
Load cell connection:	four- or six-wire-system
Maximum resistance of the connecting cable (single core) to the load cell junction box corresponding to a specific cable length of	714 m/mm ² (figure applicable for copper / $\rho = 0.0175 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$). Independent of the cross section, however, the cable length may by no means exceed 100 m. When using four wire technology to connect the analogue data processing unit the load cell cable may neither be lengthened nor shortened.

3 Schnittstellen und anschließbare Einrichtungen Interfaces and devices that may be connected

3.1 Schnittstellen Interfaces

Folgende Schnittstellen können vorhanden sein / the following interfaces may be available:
Am DWS2103:

- Serielle Schnittstelle (RS485) oder CAN Open für die Wägezellen und AED 9xxx,
 - Serielle Schnittstellen (RS 232) für Drucker und Zusatzeinrichtungen,
 - Schnittstellen für Tastatur, Maus, Monitor usw.
 - Ein ANYBUS-Schnittstellenmodul
- Die genannten Schnittstellen sind im Sinne der DIN EN 45501 rückwirkungsfrei und müssen nicht gesichert werden.

At the DWS2103:

- Serial interface (RS 485) or CAN Open for the load cells and AED 9xxx,
 - Serial interfaces (RS 232) for printer and peripheral devices
 - Interfaces for keyboard, mouse, monitor etc.
 - One ANYBUS interface module
- The interfaces stated are protective within the meaning of DIN EN 45501 and need not be protected.

3.2 Anschließbare Einrichtungen Devices that may be connected

Für Anwendungen, die der gesetzlichen messtechnischen Kontrolle unterliegen:

- Einrichtungen, für die die Eignung zum Anschluss an Waagen mit EG-Baumusterprüfbescheinigung / EG-Bauartzulassung durch einen Prüfschein (bzw. Prüfbericht oder Zertifikat) nachgewiesen ist. Der Prüfschein muss von einer benannten Stelle im Sinne der Richtlinie 2004/22/EG oder 2009/23/EC ausgestellt sein.
- Einfache, nur Daten empfangende Einrichtungen ohne Prüfschein (bzw. Zertifikat) und ohne Nennung in einer EG-Baumusterprüfbescheinigung / EG-Zulassung, wenn die Voraussetzungen gemäß WELMEC-Leitfaden 2.5 (2000), Abschnitt 3.3, erfüllt sind.

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003

Seite 10 von 16 Seiten

dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Page 10 of 16 pages

Neben dem Wägeergebnis müssen alle gemäß den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Zusatzinformationen korrekt dargestellt werden

Für nicht der gesetzlichen messtechnischen Kontrolle unterliegende Anwendungen dürfen beliebige Einrichtungen angeschlossen werden.

For applications subject to legal metrological control:

- *Devices whose suitability for connection to weighing instruments having an EC Type Examination Certificate / EC Type Approval Certificate is proved by a test certificate. The test certificate must have been issued by a Notified Body within the meaning of Directive 2004/22/EC or 2009/23/EC, respectively.*
- *Simple devices which only receive data, without test certificate (or test report) and without reference in an EC type examination certificate / EC type approval certificate, provided the conditions of WELMEC-guide 2.5 (2000), section 3.3, are met. In addition to the weighing result all supplementary information according to the relevant regulations shall be presented.*

For applications not subject to legal metrological control, any devices may be connected.

4 Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung

Requirements for production, putting into service, and use

4.1 Anforderungen an die Produktion

Requirements for production

4.1.1 Die SWA und müssen gemäß Nr. 1 ausgeführt sein.

The AGFIs shall be designed according to No. 1.

4.1.2 Andere Gewichtswerte als der unter Nr. 2.1 genannte richtlinienkonforme Messwert sind eindeutig zu bezeichnen oder gegenüber den richtlinienkonformen Gewichtswerten kenntlich zu machen. Das richtlinienkonforme Wägeergebnis der SWA wird durch die in mit dem Füllgewicht ausgezeichneten Gebinden getrennt gehaltenen Abwägungen als dokumentiert angesehen (siehe dazu 3.2).

Weight values other than the measuring value in conformity with the Directive listed under Nr. 2.1 have to be unambiguously designated or clearly discriminated from weight values in conformity with the Directive. The weighing result subject to legal control is considered as being documented by the fillings contained in separate batches designated by the fill weight (see 3.2 as well).

4.1.3 Einsatz beliebiger DMS-WZ

Using any SG-LCs

Wenn in Übereinstimmung mit dem WELMEC-Leitfaden 2.4 (2001) nachfolgend genannte Bedingungen erfüllt sind, dürfen beliebige DMS-WZ verwendet werden. Ausgenommen von dieser vereinfachenden Regelung sind besondere Konstruktionen und Einsatzbedingungen wie z.B. Einfachbiegebalken-WZ.

Any SG-LCs may be used if the following conditions corresponding to the WELMEC-Guide 2.4 (2001) are met. Special constructions and conditions of usage are excepted from this simplifying rules, e.g. single bending beam LCs.

- Es liegt ein Prüfschein (oder ein Prüfbericht) gemäß OIML R60 oder DIN EN 45501 vor, der von einer benannten Stelle im Sinne der Richtlinie 2009/23/EG ausgestellt ist.

There is a test certificate (or a test report) according to OIML R60 or DIN EN 45501 issued for the LC by a Notified Body responsible for type examination under Directive 2009/23/EC.

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003
dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Seite 11 von 16 Seiten
Page 11 of 16 pages

- Der Prüfschein enthält die WZ-Bauart(en), alle WZ-Daten, die für die Herstellererklärung zur Kompatibilität von Modulen gemäß WELMEC-Leitfaden 2 (2009) benötigt werden, sowie ggf. spezielle Anforderungen an die Krafteinleitung.
Mit „NH“ markierte WZ dürfen nur verwendet werden, wenn sie wenigstens nach DIN EN 45501 feuchtegeprüft sind.

The certificate contains the LC types and the necessary load cell data required for the manufacturer's declaration of compatibility of modules (WELMEC-Guide 2 (2009), and any particular installation requirements. An LC marked "NH" is allowed only if humidity testing according to DIN EN 45501 has been conducted on this LC.

- Die Kompatibilität der WZ bzw. des Lastaufnehmers mit dem zugehörigen Auswertegerät wird vom Hersteller anhand des Vordrucks im WELMEC-Leitfaden 2 (2009) bei der EG-Konformitätsfeststellung oder zusammen mit der EG-Konformitätserklärung nachgewiesen.

The compatibility of LC and indicator is established by the manufacturer by means of the compatibility of modules form, contained in the above WELMEC-Guide 2 (2009), at the time of EC verification or declaration of EC conformity of type.

- Die Krafteinleitungen und Lastaufnehmer entsprechen den im WELMEC-Leitfaden 2.4 (2001) aufgeführten Beispielen und generellen Prinzipien.

The load transmission devices and load receptors must conform to one of the examples shown in the WELMEC-Guide 2.4 (2001).

- 4.1.4 Die Betriebsart „Nichtselbsttätiger Betrieb“ darf als Notbetrieb angewählt werden können, dabei muss die Stillstandskontrolle wirksam sein.

The operating mode "non automatic operation" may be chosen as emergency operating mode, however, the stability of equilibrium checking device shall be operative.

- 4.1.5 Gewichtswerte aus nicht stabiler Gleichgewichtslage (ohne Stillstand) dürfen nur ohne Einheitenzeichen abgedruckt werden. Gewichtsbezogene Erläuterungen (N, Net, B, Brutto, T, Tara, o. ä.) sind zulässig. Die Bedeutung dieser Abdrucke ist in der Bedienungsanleitung zu beschreiben.

Weight values relating to a non-stable equilibrium position (without stability) may be printed only without unit symbol. Mass-related explanations (N, Net, G, Gross, T, Tare, or the like) are permitted. The meaning of these printouts is to be described in the operating instructions.

- 4.1.6 Nicht fest eingebaute Lastaufnehmer müssen einen Neigungsanzeiger (Libelle), der den Anforderungen von DIN EN 45501 Nr. 3.9.1.1 entspricht, sowie eine Nivelliereinrichtung besitzen.

Load receptors that are not fixed firmly shall be equipped with a level indicator (bubble), which meets the requirements of DIN EN 45501, No. 3.9.1.1, and with a levelling device.

- 4.1.7 Durch besondere konstruktive Maßnahmen (Überlastsicherung, ausreichend hohe Nennlast der Wägezellen o. ä.) ist eine Überlastung der Wägezellen zu verhindern.

The load cells must be protected against overloading (overload protection, sufficiently high nominal load of the load cells etc.).

- 4.1.8 Der maximale Temperaturbereich hat die Grenzen -10 °C bis +40 °C. Weicht der gewählte Temperaturbereich innerhalb dieser Grenzen ab, so ist er auf dem Kennzeichnungsschild anzugeben.

The maximum temperature range has the limits -10 °C to +40 °C. If the selected temperature range has not the same limits, however never exceeding them, it must be fixed on the descriptive plate.

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003

Seite 12 von 16 Seiten

dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Page 12 of 16 pages

4.2 Anforderungen an die Inbetriebnahme

Requirements for putting into service

Die Justierung der Waage muss mit Normalgewichten erfolgen, die an nationale Normale angeschlossen sind.

The weighing instrument shall be adjusted using standard weights which are traceable to national standards.

4.2.1 Bei Verwendung des richtlinienkonformen Datenspeichers: Durchführung von Messungen mit jeweiliger Speicherung der Daten. Überprüfung der gespeicherten Messergebnisse (Ablauf Nr. 1.5, letzter Anstrich und Bedienungsanleitung).

When using the data storage device in conformity with the Directive: Performing measurements with storage of measuring data. Checking of the stored values (procedure see No. 1.5, last hyphen and operating manual).

4.2.2 Überprüfung der Software-Version:

Checking the software version:

Taste „Par“ drücken, Menüpunkt „Information“ wählen, Enter-Taste betätigen. In der oberen Hälfte des Displays werden der „IDN“ des DWS2103, Hersteller, Gerät, Seriennummer und die Softwareversion gemäß Nr. 5.3 angezeigt.

Press key "Par", chose menu item Information, press "Enter" key. Within the upper part of the display the "IDN" of the DWS2103, manufacturer's name, device name, serial number and the software designation as per No. 5.3 are shown.

Die Software-ID des angeschlossenen AED9xxx mit AD103C wird wie oben, allerdings über den Menüpunkt „Waage“, zur Anzeige gebracht.

The software ID of the connected AED9xxx with AD103C is made displayed as described above, however, via the menu item "Waage".

4.2.3 Beim Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Anhang F der 2004/22/EG müssen der benannten Stelle die Unterlagen nach Nr. 5.1 vorgelegt werden.

When applying the conformity assessment procedure according to annexes F of 2004/22/EC the documents according to No. 5.1 shall be made available to the notified body.

4.3 Anforderungen an die Verwendung

Requirements with regard to using the instrument

4.3.1 In Bezug auf Langzeitspeicherung der Wägeergebnisse sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

In case of long term storage of the weighing results the following conditions must be fulfilled:

- Die Wägeergebnisse werden zusammen mit einer Kennzeichnung gespeichert (z.B. Nummer oder Datum und Uhrzeit). Diese Kennzeichnungen sind auch auf den Belegen, die mit den Zusatzeinrichtungen nach Nr. 3.2 erstellt werden, anzugeben.

The record of each individual weighing result contains a unique reference (e.g. an id-number, or date and time). These references are to be indicated on receipts printed by devices mentioned in No. 3.2.

- Die Überprüfung der gespeicherten Wägeergebnisse muss für die beteiligten Vertragspartner möglich sein.

A review of the stored weighing results must be possible for all parties involved.

- Die Benutzer dieses Datenspeichers sind wie folgt zu informieren:

The users of this data storage device must be informed as follows:

- Der Benutzer allein ist für eine ausreichende Speicherkapazität und für das Vorhandensein der gespeicherten Wägeergebnisse verantwortlich.

The user only is responsible for sufficient storage capacity and the availability of the weighing results.

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003

Seite 13 von 16 Seiten

dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Page 13 of 16 pages

- Kontinuierlich ausgegebene Wägeergebnisse ohne vorherige Speicherung und ohne Identifikation dürfen nur für nicht der gesetzlichen messtechnischen Kontrolle unterliegenden Verwendungen (Dosieren, Steuern o.ä.) verwendet werden. Aufgrund der fehlenden Identifikation ist eine Weitergabe für der gesetzlichen messtechnischen Kontrolle unterliegenden Verwendungen nicht zulässig.
Continuously output weighing results without previous storage nor with unique reference may only be used for applications not subject to legal metrological control (batching, controlling purposes). Since the reference is missing a transfer for purposes subject to legal metrological control is not allowed,
- Die Geschäftsbelege, die von einer nicht der gesetzlichen messtechnischen Kontrolle unterliegenden Zusatzeinrichtung nach der Vorbemerkung zu Anhang I der Richtlinie 2009/23/EG, müssen folgende Informationen enthalten:
The bills that are prepared by a peripheral device not subject to legal metrological control according to the preamble to Annex I of Directive 2009/23/EC and shall also contain the following information:
 - eine eindeutige, nachvollziehbare Identifikation für jedes Wägeergebnis und
a unambiguous, understandable reference to any weighing result and
 - für die Verwendung in Deutschland zusätzlich einen Hinweis, dass die Wägeergebnisse anhand der Identifikation mit den richtlinienkonform gespeicherten Wägeergebnissen verglichen bzw. überprüft werden können.
when used in Germany an additional hint that on basis of the reference the weighing results may be compared with the weighing results stored in conformity with the Directive.

5 Kontrolle in Betrieb befindlicher Geräte

Surveillance of instruments in service

5.1 Unterlagen für die Prüfung

Documents for the test

- Kopie der Baumusterprüfbescheinigung mit Anlage
- Bedienungsanleitung
- Bei Bedarf sind Kopien der Prüfscheine von Modulen und Zusatzeinrichtungen vorzulegen.
- *Copy of the EC-type examination certificate including the Annex hereto*
- *operating instructions*
- *Copies of the test certificates of modules and peripheral devices if necessary.*

5.2 Prüfeinrichtungen

Testing facilities

- Normalgewichte / *standard weights*
- geeignete Kontrollwaage zum Nachwägen der abgefüllten Gebinde / *suitable control weighing instrument for weighing the batches*

5.3 Identifizierung

Identification

- Hardware: Auswertegerät gemäß Abbildungen 1 bis 3 / *indicator as per figures 1 to 3*
- Die Softwareversion der richtlinienkonformen Software wird durch folgende Kennungen identifiziert / *The version of the software in conformity with the Directive is identified by the following designations:*

DWS 2103: P20x

AED9xxx mit / *with* AD103C : P78.x

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003
dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Seite 14 von 16 Seiten
Page 14 of 16 pages

Der Platzhalter „x“ kann die Ziffern 1 bis 9 annehmen. Er steht für Änderungen der nicht der gesetzlichen messtechnischen Kontrolle unterliegenden Software.
The wildcard "x" may adopt the numbers 1 to 9. It is for modification of software not subject legal metrological control.

5.4 Messtechnische Prüfung

Metrological test

- Gemäß OIML R61-1, No. 6
According to OIML R61-1, No. 6
- Für die Prüfung der Stillstandskontrolle (siehe Nr. 2.1.1) gilt DIN EN 45501 / OIML R76-1, Nr. 4.4.5 und zugehöriger Anhang A Nr. 4.12.
When testing the stability of equilibrium control device (see No. 2.1.1) DIN EN 45501 / OIML R76-1, No. 4.4.5 and corresponding annex A No. 4.12 have to be considered.

Bei Prüfung der Big-Bag-Funktion sind die Fehlergrenzen nach EO 10-1, Nr. 4.3 und MID, Anhang MI-006, Kapitel III, Nr. 2.3 bezogen auf das Gesamt-Füllgewicht einzuhalten.
When checking the Big-Bag funktion the error limits have to be fulfilled in respect of the total net quantity in according to EO 10-1, No. 4.3 and MID, Annex MI-006, Chapter III, No. 2.3.

6 Sicherungsmaßnahmen

Securing provisions

6.1 Versiegelung

Sealing

Sicherungsmarken sind an folgenden Stellen anzubringen: / *Sealings must be affixed at the following locations:*

- über dem Justierschalter / *above the calibration switch*
- über mindestens einer Gehäuseschraube / *above at least one screw of the cover*

Siehe Abbildung 3 / *see figure 3*

Das Verbindungskabel zu den angeschlossenen Wägezellen / Modulen muss nicht gesichert werden, da die Signale verschlüsselt übertragen werden. Die Zuordnung Wägezelle / Modul zum Anzeige- und Bedienterminal muss durch geeignete Beschilderung sichergestellt sein.

The cable connection to the attached load cells / modules does not have to be secured, because the signals are encrypted. The allocation of the load cell / module to the indication and operation terminal must be ensured via appropriate labeling.

6.2 Logbuch

Data logger

Nicht vorhanden.

Not available.

7 Kennzeichnungen und Aufschriften

Labelling and inscriptions

7.1 Informationen, die dem Gerät beizufügen sind

Information to be borne by and accompany the instrument

Bedienungsanleitung

Operating manual

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003
dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Seite 15 von 16 Seiten
Page 15 of 16 pages

7.2 Kennzeichnungen und Aufschriften *Designations and inscriptions*

Das Kennzeichnungsschild mit Stempelstelle nach 2004/22/EG, Anhang I, Nr. 9 bzw. OIML R61, Nr. 3.10 ist auf der Frontseite des DWS 2103 angebracht.
The designation plate including the stamping location according to 2004/22/EC, Annex I, No. 9, and OIML OIML R61, No 3.10 respectively, is located on the front side of the DWS 2103.

Die Waagendaten Max, Min und Teilungswert (d) müssen in der Nähe der Hauptanzeige sichtbar sein, ggf. wiederholt dargestellt werden.
The data Min, Max, and scale interval (d) of the instrument shall be visible in the vicinity of the main indicating device or shall be repeated there, respectively.

8 Abbildungen *Drawings*

Abbildung / figure 1: Frontansicht / front view DWS2103



Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 19.05.2011, Bescheinigung Nr: DE-11-MI006-PTB003
dated 19.05.2011, Certificate number: DE-11-MI006-PTB003

Seite 16 von 16 Seiten
Page 16 of 16 pages

Abbildung / figure 2: Rückseite / rear side DWS2103


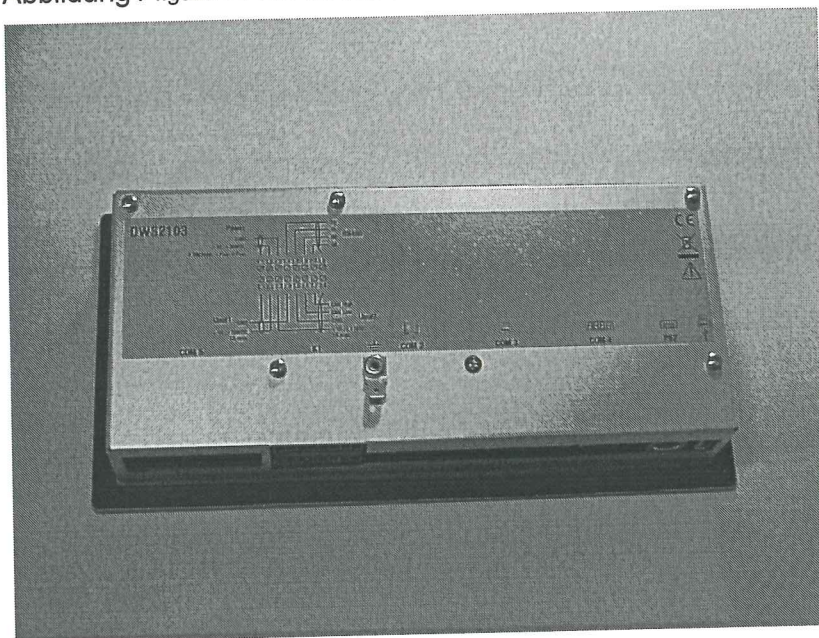


Abbildung / figure 3: Sicherung / securing DWS2103

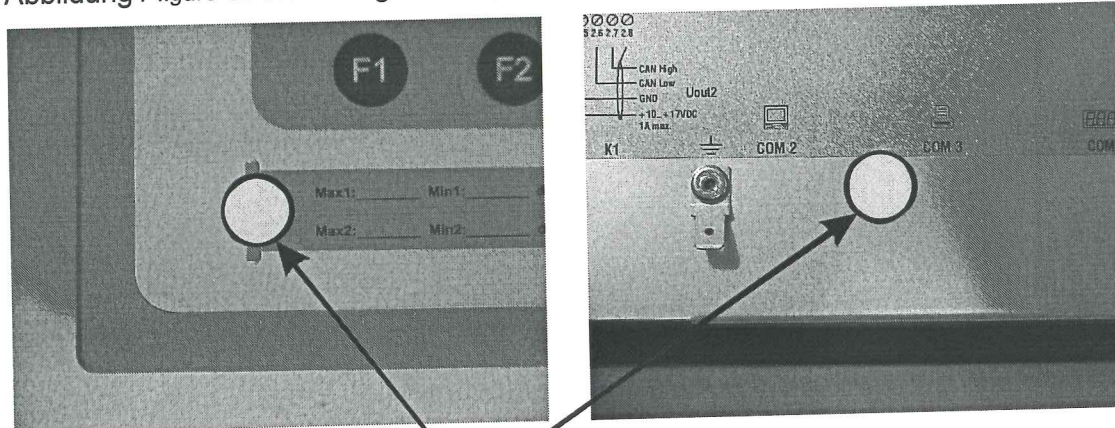

Sicherungsmarke über Justierschalter
und einer Gehäuseschraube
Securing mark over adjustment switch
and one screw of the housing